



このお薬は、肛門から挿入して使用するお薬です。  
指定された回数・量を守り、下記の手順でご使用ください。

※下の図はこの「使い方説明書」で使用している器具の部品名です。  
【キャップがはまった状態】



【キャップをはずした状態】

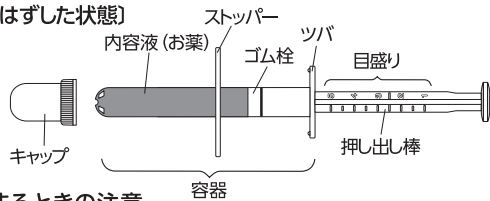

**！ 使用する時の注意**


- 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。
- 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、必ずあらかじめ指示された目盛まで余分なお薬を出してから、注入してください。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。
- 肛門部に挿入するまで、容器先端を上に向け、押し出し棒を押さないでください。(お薬がとび出してしまいます。)
- 挿入中に、強い抵抗感がありましたら、それ以上挿入せず、角度をかえて挿入し直してください。
- 挿入が不十分ですと、お薬が肛門より漏れ出ることがありますので、必ずストッパー部分が肛門にあたるまで挿入してください。
- 使用後に残ったお薬は使用しないでください。
- このお薬は肛門への挿入以外には使用しないでください。

**！ 保管上の注意・捨てる時の注意**


- お薬は使用するまで包装袋を開けず、直前に開封し、速やかに使用してください。
- お薬がキャップにしみ出ていることがありますが、不良品ではありません。
- 使用後は、キャップをして捨ててください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

このお薬は、肛門から挿入して使用するお薬です。  
指定された回数・量を守り、下記の手順でご使用ください。

※下の図はこの「使い方説明書」で使用している器具の部品名です。  
【キャップがはまった状態】



【キャップをはずした状態】

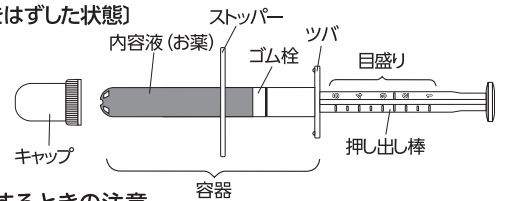

**！ 使用する時の注意**


- 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。
- 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、必ずあらかじめ指示された目盛まで余分なお薬を出してから、注入してください。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。
- 肛門部に挿入するまで、容器先端を上に向け、押し出し棒を押さないでください。(お薬がとび出してしまいます。)
- 挿入中に、強い抵抗感がありましたら、それ以上挿入せず、角度をかえて挿入し直してください。
- 挿入が不十分ですと、お薬が肛門より漏れ出ることがありますので、必ずストッパー部分が肛門にあたるまで挿入してください。
- 使用後に残ったお薬は使用しないでください。
- このお薬は肛門への挿入以外には使用しないでください。

**！ 保管上の注意・捨てる時の注意**


- お薬は使用するまで包装袋を開けず、直前に開封し、速やかに使用してください。
- お薬がキャップにしみ出ていることがありますが、不良品ではありません。
- 使用後は、キャップをして捨ててください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

このお薬は、肛門から挿入して使用するお薬です。  
指定された回数・量を守り、下記の手順でご使用ください。

※下の図はこの「使い方説明書」で使用している器具の部品名です。  
【キャップがはまった状態】



【キャップをはずした状態】

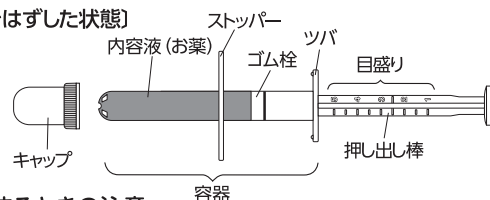

**！ 使用する時の注意**


- 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。
- 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、必ずあらかじめ指示された目盛まで余分なお薬を出してから、注入してください。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。
- 肛門部に挿入するまで、容器先端を上に向け、押し出し棒を押さないでください。(お薬がとび出してしまいます。)
- 挿入中に、強い抵抗感がありましたら、それ以上挿入せず、角度をかえて挿入し直してください。
- 挿入が不十分ですと、お薬が肛門より漏れ出ることがありますので、必ずストッパー部分が肛門にあたるまで挿入してください。
- 使用後に残ったお薬は使用しないでください。
- このお薬は肛門への挿入以外には使用しないでください。

**！ 保管上の注意・捨てる時の注意**


- お薬は使用するまで包装袋を開けず、直前に開封し、速やかに使用してください。
- お薬がキャップにしみ出ていることがありますが、不良品ではありません。
- 使用後は、キャップをして捨ててください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

このお薬は、肛門から挿入して使用するお薬です。  
指定された回数・量を守り、下記の手順でご使用ください。

※下の図はこの「使い方説明書」で使用している器具の部品名です。  
【キャップがはまった状態】



【キャップをはずした状態】

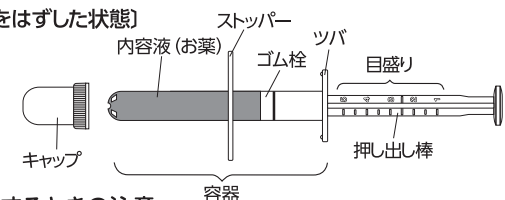

**！ 使用する時の注意**


- 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。
- 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、必ずあらかじめ指示された目盛まで余分なお薬を出してから、注入してください。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。
- 肛門部に挿入するまで、容器先端を上に向け、押し出し棒を押さないでください。(お薬がとび出してしまいます。)
- 挿入中に、強い抵抗感がありましたら、それ以上挿入せず、角度をかえて挿入し直してください。
- 挿入が不十分ですと、お薬が肛門より漏れ出ることがありますので、必ずストッパー部分が肛門にあたるまで挿入してください。
- 使用後に残ったお薬は使用しないでください。
- このお薬は肛門への挿入以外には使用しないでください。

**！ 保管上の注意・捨てる時の注意**


- お薬は使用するまで包装袋を開けず、直前に開封し、速やかに使用してください。
- お薬がキャップにしみ出ていることがありますが、不良品ではありません。
- 使用後は、キャップをして捨ててください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

## 挿入の仕方


- 1 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。



- 2 容器先端を上向きにし、気泡が上がったのを確認して、容器先端のキャップをはずします。




- 3 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、目盛りを目安に押し出し棒を押して余分なお薬を押し出します。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。




- 4 必要に応じて容器先端（挿入部分の先端）に内容液（お薬）あるいはワセリンを塗り広げ、すべりをよくして、挿入しやすくします。



- 5 肛門内に容器のストッパーの部分まで、ゆっくりと挿入します。



- 6 ツバの部分を持ちながら、押し出し棒をゆっくり押ししてお薬を注入します。



- 7 注入後、容器を肛門から抜き取ります。

- 8 使用後は、容器にキャップをして捨ててください。

使用方法、副作用などの詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元

**久光製薬株式会社**

作成年月:2022年1月


〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

3521HN


ECKS002R000

## 挿入の仕方


- 1 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。



- 2 容器先端を上向きにし、気泡が上がったのを確認して、容器先端のキャップをはずします。




- 3 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、目盛りを目安に押し出し棒を押して余分なお薬を押し出します。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。




- 4 必要に応じて容器先端（挿入部分の先端）に内容液（お薬）あるいはワセリンを塗り広げ、すべりをよくして、挿入しやすくします。



- 5 肛門内に容器のストッパーの部分まで、ゆっくりと挿入します。



- 6 ツバの部分を持ちながら、押し出し棒をゆっくり押ししてお薬を注入します。



- 7 注入後、容器を肛門から抜き取ります。

- 8 使用後は、容器にキャップをして捨ててください。

使用方法、副作用などの詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元

**久光製薬株式会社**

作成年月:2022年1月


〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

3521HN


ECKS002R000

## 挿入の仕方


- 1 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。



- 2 容器先端を上向きにし、気泡が上がったのを確認して、容器先端のキャップをはずします。




- 3 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、目盛りを目安に押し出し棒を押して余分なお薬を押し出します。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。




- 4 必要に応じて容器先端（挿入部分の先端）に内容液（お薬）あるいはワセリンを塗り広げ、すべりをよくして、挿入しやすくします。



- 5 肛門内に容器のストッパーの部分まで、ゆっくりと挿入します。



- 6 ツバの部分を持ちながら、押し出し棒をゆっくり押ししてお薬を注入します。



- 7 注入後、容器を肛門から抜き取ります。

- 8 使用後は、容器にキャップをして捨ててください。

使用方法、副作用などの詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元

**久光製薬株式会社**

作成年月:2022年1月


〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

3521HN


ECKS002R000

## 挿入の仕方


- 1 押し出し棒を押しやすくするために、キャップがはずれないようにキャップを押えながら、ゴム栓部分が動く程度に軽く押し出し棒を押しします。



- 2 容器先端を上向きにし、気泡が上がったのを確認して、容器先端のキャップをはずします。




- 3 投与量の調節は、容器先端を斜め上に向け、目盛りを目安に押し出し棒を押して余分なお薬を押し出します。この時、ストッパー部にティッシュペーパー等をあて、お薬を吸い込ませますと、液だれが防止できます。




- 4 必要に応じて容器先端（挿入部分の先端）に内容液（お薬）あるいはワセリンを塗り広げ、すべりをよくして、挿入しやすくします。



- 5 肛門内に容器のストッパーの部分まで、ゆっくりと挿入します。



- 6 ツバの部分を持ちながら、押し出し棒をゆっくり押ししてお薬を注入します。



- 7 注入後、容器を肛門から抜き取ります。

- 8 使用後は、容器にキャップをして捨ててください。

使用方法、副作用などの詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元

**久光製薬株式会社**

作成年月:2022年1月

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

3521HN

ECKS002R000